

Утвержден  
ТРОН.407290.004-ЛУ

## **ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АДИ**

### **Руководство по эксплуатации**

ТРОН.407290.004 РЭ

Редакция 2.1



ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»  
193318, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2  
Телефон, факс: +7 (812) 326-10-50  
Сайт ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»: [www.termotronic.ru](http://www.termotronic.ru)  
Служба технической поддержки: [support@termotronic.ru](mailto:support@termotronic.ru)  
тел. 8-800-333-10-34

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>5</b>
2.1	Технические характеристики .....	5
2.1.1	<i>Метрологические характеристики .....</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Входы импульсные .....</i>	<i>5</i>
2.1.3	<i>Входы токовые .....</i>	<i>5</i>
2.1.4	<i>Выход токовый .....</i>	<i>5</i>
2.1.5	<i>Дискретный выход .....</i>	<i>6</i>
2.1.6	<i>Архивы .....</i>	<i>6</i>
2.1.7	<i>Питание .....</i>	<i>7</i>
2.1.8	<i>Интерфейсы .....</i>	<i>7</i>
2.1.9	<i>Габаритные размеры и масса .....</i>	<i>7</i>
2.2	Эксплуатационные характеристики .....	7
<b>3</b>	<b>ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....</b>	<b>8</b>
3.1	Состав .....	8
3.2	Режимы работы .....	8
3.3	Маркировка и пломбирование .....	8
3.4	Защита от несанкционированного вмешательства .....	9
<b>4</b>	<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....</b>	<b>9</b>
5.1	Настройка.....	9
5.2	Размещение.....	10
5.3	Подключение .....	10
5.4	Ввод в эксплуатацию .....	11
<b>6</b>	<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</b>	<b>13</b>
7.1	Внешний осмотр и проверка работоспособности .....	13
7.2	Периодическая поверка.....	13
<b>8</b>	<b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....</b>	<b>13</b>
<b>10</b>	<b>ХРАНЕНИЕ .....</b>	<b>13</b>
	Приложение А – Пример отчёта .....	14
	Ссылочные нормативные документы .....	15

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) распространяется на преобразователи измерительные АДИ (далее – АДИ) и предназначено для ознакомления с их характеристиками, устройством, конструкцией, правилами монтажа и эксплуатации.

В руководстве применены следующие обозначения и сокращения:

**В** – вес импульса водосчётчика

**G** – расход воды

**I** – постоянный ток

**N** – количество импульсов, поступивших от водосчётчика

**P** – давление воды

**V** – объём воды

**ВС** – водосчётчик

**КС** – контрольная сумма

**ПД** – преобразователь давления

**ПК** – персональный компьютер

**ПО** – программное обеспечение

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в руководство. Непрерывная работа над повышением надёжности и улучшением АДИ может привести к некоторым непринципиальным изменениям, не отражённым в настоящей редакции руководства.

Заказ АДИ осуществляется по карте заказа [4.1] <sup>1</sup>.

Преобразователи измерительные АДИ зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ.

<sup>1</sup> Здесь и далее в квадратных скобках [...] указан номер документа по разделу «Ссылочные нормативные документы».

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЯ

АДИ предназначены для преобразований импульсных сигналов счётчиков объёма и токовых сигналов преобразователей давления в значения объёма и давления, а также для преобразований цифрового сигнала (соответствующего расходу) расходомеров в выходной сигнал постоянного тока.

АДИ обеспечивают:

- преобразование входных сигналов частотой до 20 Гц (до 1000 Гц), сформированных на пассивных (активных) выходах счётчиков объёма, в значения объёма воды по одному или двум измерительным каналам;
- преобразование входных сигналов постоянного тока от 4 до 20 мА, сформированных на токовых выходах преобразователей избыточного давления, в значения давления воды по одному или двум измерительным каналам;
- преобразование текущего расхода воды по интерфейсу LIN от расходомера «Питерфлоу РС» в выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА;
- формирование дискретного выходного сигнала в зависимости от значения контролируемого параметра;
- преобразование цифрового сигнала, сформированного на выходе LIN расходомера «Питерфлоу РС» и несущего измерительную и диагностическую информацию, в сигнал интерфейса RS-232 или Ethernet;
- измерение текущего времени, времени работы и времени отсутствия сетевого питания;
- архивирование часовых, суточных, месячных и интегральных (нарастающим итогом) значений объёма воды по двум каналам измерения объёма и по интерфейсу LIN от расходомера «Питерфлоу РС»;
- архивирование часовых, суточных, месячных значений давления воды по двум каналам измерения давления.

АДИ выпускаются по техническим условиям [5.3] в исполнениях, указанных в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Исполнения

Исполнение	Наличие токового выхода OUT	Наличие архива	Количество				Наличие дискретного выхода DOUT*
			измерительных входов		интерфейсов		
			V	P	LIN	RS-232 (Ethernet)	
АДИ-0-0	нет	нет	2	2	1	1	есть
АДИ-0-1	нет	есть	2	2	1	1	есть
АДИ-1-0	есть	нет	2	2	1	1	нет
АДИ-1-1	есть	есть	2	2	1	1	нет

\* Дискретный выход только в АДИ аппаратного исполнения 2.0 и выше.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Технические характеристики

#### 2.1.1 Метрологические характеристики

Диапазоны и пределы погрешности измерений и преобразований в рабочих условиях эксплуатации указаны в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Метрологические характеристики

Параметр	Диапазон значений	Пределы погрешности
Объём <sup>1)</sup>	от 0 до 10 <sup>9</sup> м <sup>3</sup>	± 1 ед. мл. разр. (абсолютная)
Избыточное давление <sup>2)</sup>	от 0 до 2,5 МПа	± 0,25 % (приведённая)
Постоянный ток <sup>3)</sup>	от 4 до 20 мА	± 0,25 % (приведённая)
Время <sup>4)</sup>	от 0 до 150000 ч	± 5 с/сутки (абсолютная)

<sup>1)</sup> Пропорционально количеству импульсов на импульсном входе (V1, V2).

<sup>2)</sup> Пропорционально постоянному току на токовом входе (P1, P2).

<sup>3)</sup> Пропорционально расходу по интерфейсу LIN. Только для АДИ-1-0, АДИ-1-1.

<sup>4)</sup> Время текущее, время работы, время отсутствия питания. Только для АДИ-0-1, АДИ-1-1.

#### 2.1.2 Входы импульсные

Для АДИ любого исполнения: назначение входов V1 и V2 – подключение ВС, расходомера с пассивным импульсным выходом (открытый коллектор, геркон) и характеристиками, указанными в таблице 2.1.

Измеряемый параметр: количество импульсов.

Таблица 2.1 – Водосчётчики

Параметр	Значение
Вес импульса, л/имп.	от 0,001 до 1000
Частота, Гц, не более	20
Ток утечки в закрытом состоянии, мкА, не более	1
Падение напряжения в открытом состоянии при токе 1 мА, В, не более	0,6

Примечание – Допускается использовать расходомеры с активным выходным сигналом частотой до 1000 Гц и напряжением до 12 В.

#### 2.1.3 Входы токовые

Для АДИ любого исполнения: назначение входов P1 и P2 – подключение ПД с характеристиками, указанными в таблице 2.2.

Измеряемый параметр: постоянный ток в диапазоне от 4 до 20 мА.

Таблица 2.2 – Преобразователи давления

Параметр	Значение
Избыточное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	от 0 до 2,5 (25,49)
Диапазон тока, мА	от 4 до 20

#### 2.1.4 Выход токовый

Только для исполнений АДИ-1-0, АДИ-1-1: токовый выход OUT с сигналом постоянного тока от 4 до 20 мА, пропорционального текущему расходу по интерфейсу LIN от расходомера «Питерфлоу РС». Сопротивление нагрузки: не более 200 Ом.

### 2.1.5 Дискретный выход

Только для исполнений АДИ-0-0 и АДИ-0-1.

Сигналы формируются путем изменения состояния (замкнуто/разомкнуто) выходной цепи. Характеристики выходной цепи:

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| – Тип выхода                         | открытый коллектор (ОК). |
| – Максимально допустимое напряжение  | 15 В.                    |
| – Максимально допустимый ток         | 50 мА.                   |
| – Сопротивление в открытом состоянии | не более 15 Ом.          |

Дискретный выход предназначен для сигнализации о наступлении контролируемого события. Состоянию «Включено» дискретного выхода соответствует низкий уровень выходного сопротивления, а состоянию «Выключено» – высокий.

Режимы работы дискретного выхода:

1. Выключен.
2. Включение по срабатыванию дискретного входа V1 (V2).
3. Включение при  $P1 (P2) > \text{уставки MAX}$ ,  $P1 (P2) < \text{уставки MIN}$ .
4. Включение при  $P1 (P2) < \text{уставки MIN}$ .
5. Включение при  $(P1 (P2) < \text{уставки MIN})$  или  $(P1 (P2) > \text{уставки MAX})$ .
6. Включение при  $(P1 (P2) > \text{уставки MIN})$  и  $(P1 (P2) < \text{уставки MAX})$ .
7. Включение при  $G > \text{уставки MAX}$ .
8. Включение при  $G < \text{уставки MIN}$ .
9. Включение при  $(G < \text{уставки MIN})$  или  $(G > \text{уставки MAX})$ .
10. Включение при  $(G > \text{уставки MIN})$  и  $(G < \text{уставки MAX})$ .
11. Включение по RS232.
12. Включение по факту обнаружения пустой трубы.

### 2.1.6 Архивы

Только для исполнений АДИ-0-1, АДИ-1-1: значения измеренных величин регистрируются и сохраняются в энергонезависимой памяти.

Архив формируется на часовых, суточных и месячных интервалах, ёмкость архива 1440 часов, 180 суток, 36 месяцев соответственно. Архивные записи формируются по кольцевому принципу: каждая очередная запись сверх установленного объёма – взамен первой (самой ранней) записи. Каждая запись содержит следующие данные:

- дату и время;
- минимальное, среднее и максимальное давление по каждому токовому входу;
- объём и вес импульса по каждому импульсному входу;
- объём по интерфейсу LIN от расходомера «Питерфлоу РС»;
- интегральные (нарастающим итогом) значения объёмов;
- время работы;
- диагностическую информацию;
- продолжительность отключения внешнего питания.

Сброс архива измеренных величин, в том числе интегральных значений объёмов, разрешён только в режиме настройки и невозможен при штатной эксплуатации.

АДИ обеспечивает формирование фискального архива внутренних событий ёмкостью 256 записей. Фискальный архив сохраняется (не сбрасывается), записи не стираются.

### 2.1.7 Питание

Для АДИ любого исполнения: электрическое питание осуществляется от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением от 10,8 до 13,2 В. Потребляемый ток: не более 50 мА. Для подключения источника питания предназначены входы  $\pm 12V$ .

Только для исполнений АДИ-0-1, АДИ-1-1: встроенный аккумулятор с номинальным напряжением 3,6 В и номинальной ёмкостью 11 мА·ч. При отсутствии внешнего питания обеспечивается счёт импульсов (длительностью не менее 50 мс) и вычисление объёмов. Продолжительность автономной работы: не менее 100 часов.

### 2.1.8 Интерфейсы

Для АДИ любого исполнения: назначение интерфейсов LIN и RS-232 (Ethernet) – подключение внешних устройств. Обеспечивается сопряжение:

- с расходомером «Питерфлоу РС» по интерфейсу LIN;
- с ПК по последовательному интерфейсу RS-232, протоколы обмена Modbus ASCII;
- с ПК по последовательному интерфейсу Ethernet.

### 2.1.9 Габаритные размеры и масса

Для АДИ любого исполнения: габаритные размеры и масса (без упаковки) указаны в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Размеры и масса

Параметр	Значение
Длина, мм, не более	90
Ширина, мм, не более	36
Высота, мм, не более	63
Масса, кг, не более	0,3

## 2.2 Эксплуатационные характеристики

АДИ сохраняет свои характеристики при эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных газов и паров воды, при воздействии факторов внешней среды с параметрами, указанными в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Рабочие условия эксплуатации

Параметр	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	от 0 до 50
Относительная влажность воздуха <sup>1)</sup> , %, не более	95
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 (630) до 106,7 (800)
Напряжённость магнитного поля <sup>2)</sup> , А/м, не более	400
Амплитуда механической вибрации <sup>3)</sup> , мм, не более	0,35

<sup>1)</sup> При температуре 35°С.

<sup>2)</sup> Частотой 50 Гц.

<sup>3)</sup> В диапазоне частот от 10 до 55 Гц.

Защита от поражения электрическим током: класс III по ГОСТ 12.2.007.0 [1.1].

Защита корпуса от проникновения внешних твёрдых предметов и воды: группа IP40 по ГОСТ 14254 [1.2].

Средний срок службы: 12 лет.

Средняя наработка на отказ: 50000 часов.

## 3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 3.1 Состав

АДИ выполнен в пластмассовом корпусе. Общий вид АДИ любого исполнения показан на рисунке 3.1. Назначение клеммников указано в таблице 3.1.

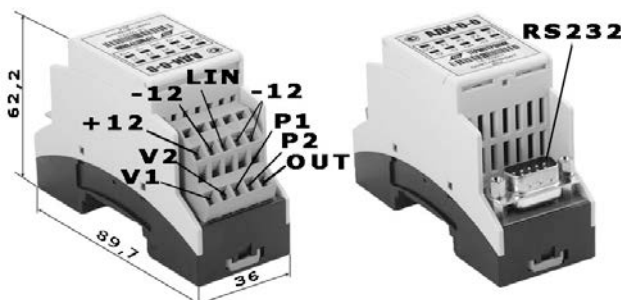


Рисунок 3.1 – Общий вид

Таблица 3.1 – Клеммники

Обозначение	Назначение	Исполнение АДИ
V1, V2	Вход импульсный	любое
P1, P2	Вход токовый	любое
OUT	Выход токовый Выход дискретный	АДИ-1-0, АДИ-1-1 АДИ-0-0, АДИ-0-1
LIN	Интерфейс для «Питерфлоу РС»	любое
RS-232	Интерфейс для ПК	любое
+12	Питание +12 В	любое
-12	Питание -12 В (общий, три контакта)	любое

### 3.2 Режимы работы

#### • РАБОТА

Используют при штатной эксплуатации (по прямому назначению).

Обеспечивается: вычисление объема и давления, преобразование интерфейсного сигнала от расходомера «Питерфлоу РС» в выходной сигнал интерфейса RS-232 (Ethernet) и в выходной токовый сигнал (только для исполнений АДИ-1-0, АДИ-1-1), формирование архива (только для исполнений АДИ-0-1, АДИ-1-1).

Примечание – Для считывания архива с помощью ПК используют ПО «АРХИВАТОР», размещенное на сайте ЗАО «ТЕРМОТРОНИК».

#### • НАСТРОЙКА

Используют для конфигурирования АДИ. Признак разрешения конфигурирования устанавливается при нажатии кнопки доступа (под откидной крышкой АДИ) и сбрасывается после повторного нажатия кнопки или через один час.

Обеспечивается: изменение настроечных параметров, сброс архива.

Примечание – Для конфигурирования с помощью ПК используют сервисное ПО «АДИ КОНФИГУРАТОР», размещенное на сайте ЗАО «ТЕРМОТРОНИК».

### 3.3 Маркировка и пломбирование

Маркировка АДИ отображает следующую информацию: наименование, обозначение, исполнение и заводской номер АДИ, знак утверждения типа, товарный знак предприятия-изготовителя.

Пломбирование АДИ выполняют путём нанесения оттиска клейма поверителя на пломбировочной ленте после поверки.



### 3.4 Защита от несанкционированного вмешательства

Уровень защиты встроенного ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286 [2.1]. Защита метрологически значимой части ПО обеспечивается формированием КС исполняемого кода. Значение КС исполняемого кода (11АВ), установленное в описании типа, записывают в паспорт [5.1] АДИ при выпуске из производства.

Контроль неизменности калибровок обеспечивается формированием КС «Контрольная сумма калибровок», значение которой записывают в паспорт [5.1] АДИ при поверке.

Регистрация событий, связанных с настройкой, калибровкой, сбросом архива измеренных величин, установкой часов обеспечивается формированием нестираемого фискального архива.

## 4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с АДИ допускается обслуживающий персонал, изучивший настоящее руководство и прошедший инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.

При эксплуатации АДИ должны соблюдаться правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [3.1], правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок [3.2].

По способу защиты человека от поражения электрическим током АДИ относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0 [1.1]. Элементы для заземления отсутствуют.

**ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация во взрывоопасных помещениях!**

## 5 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### 5.1 Настройка

Настройку АДИ рекомендуется выполнять до подключения внешних устройств на месте эксплуатации.

ПК подключить стандартным нуль-модемным кабелем к вилке DB9M (интерфейс RS-232) АДИ.

Примечание – Нуль-модемный кабель не входит в комплект поставки АДИ. Для подключения ПК с портом USB использовать преобразователь USB↔RS-232.

Подключить к АДИ блок питания с номинальным напряжением 12 В.

Поднять крышку АДИ и нажатием (с помощью отвёртки) кнопки доступа по рисунку 5.1 установить признак разрешения конфигурирования.

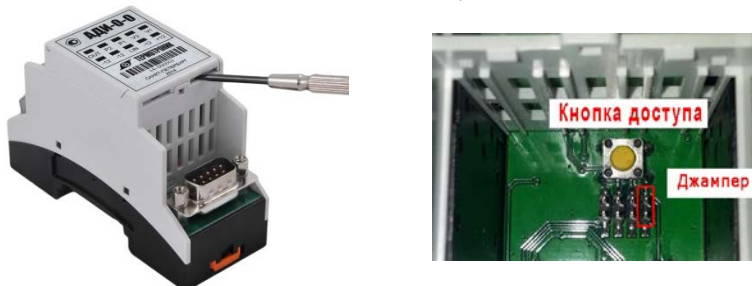


Рисунок 5.1 – Разрешение/запрет конфигурирования

С помощью ПО «АДИ КОНФИГУРАТОР» выполнить следующие операции:

- установить текущую дату и время, только для исполнений АДИ-0-1, АДИ-1-1;
- в зависимости от типа и характеристик внешних устройств, подключённых к АДИ, установить требуемые значения настроечных параметров;
- распечатать отчёт о настройках.

Пример отчёта о настройках приведён в приложении А.

Повторно нажать кнопку доступа и убедиться в запрете конфигурирования.

Примечание – Без нажатия кнопки доступа признак разрешения конфигурирования сбрасывается автоматически через один час.

## 5.2 Размещение

Рабочие условия в месте установки АДИ должны соответствовать требованиям п. 2.2. Рекомендуемая температура окружающего воздуха: от 15 до 25 °С.

Место установки не должно быть вблизи силовых кабелей, электрощитов, сварочных аппаратов и т.п., иначе АДИ следует размещать внутри металлической оболочки (шкафа монтажного), присоединённой к контуру защитного заземления.

Для крепления АДИ на месте установки использовать DIN-рейку и защёлки.

## 5.3 Подключение

Линии связи рекомендуется прокладывать:

- неэкранированными кабелями, если на расстоянии до 3 м от них отсутствуют силовые проводники с индуктивной нагрузкой более 1 А (трансформаторы, сварочные аппараты, двигатели) и прочие источники электромагнитных помех;
- экранированными кабелями (в металлических трубах, металлорукавах), если источники электромагнитных помех имеются. С целью исключения возможности замыкания экранов кабелей с другими цепями следует применять кабели, имеющие наружную изоляцию поверх экрана.

Схема подключения внешних устройств к АДИ приведена на рисунке 5.2. Провода (с сечением жил от 0,06 до 2 мм<sup>2</sup>) подключить к зажимным клеммникам АДИ. Рекомендуется предварительно разделать каждый провод на наконечник-гильзу с изолированным фланцем.

- Входы V1, V2 – для АДИ любого исполнения.

Показано подключение ВС с пассивным и с активным выходом. Обеспечивается вычисление объёмов.

- Входы P1, P2 – для АДИ любого исполнения.

Показано подключение ПД с выходным сигналом постоянного тока. Обеспечивается вычисление давлений.

- Выход OUT – только для исполнений АДИ-1-0, АДИ-1-1.

Показано подключение нагрузки. Значение выходного тока пропорционально текущему расходу по интерфейсу LIN от расходомера «Питерфлоу РС».

- Выход DOUT – только для исполнений АДИ-0-0, АДИ-0-1.



- Вход LIN – для АДИ любого исполнения.

Только для подключения расходомера «Питерфлоу РС» по интерфейсу LIN.


- Входы +12V и –12V – для АДИ любого исполнения.

Вход –12V: общий для всех входных и выходных сигналов. Допускается питание АДИ от отдельного блока питания, от блока питания расходомера «Питерфлоу РС» или от блока питания ПД.

**ВНИМАНИЕ!** Использовать блок питания ТОЛЬКО с номинальным напряжением 12 В!

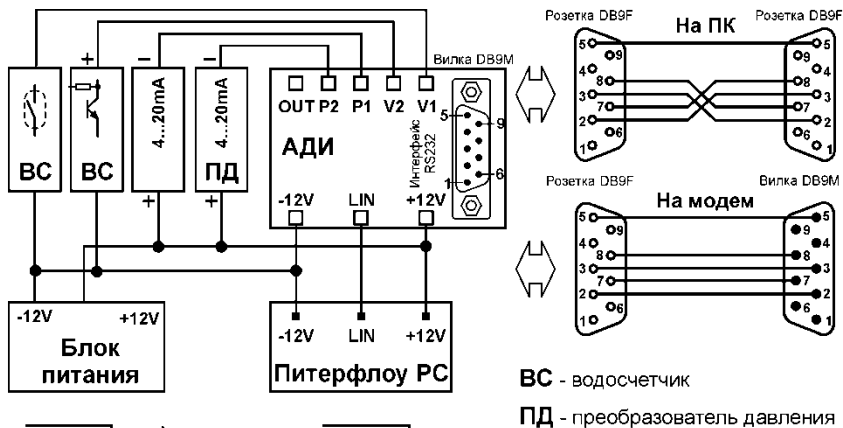

Токовый выход  
АДИ-1-0 или АДИ-1-1



Дискретный выход  
АДИ-0-0 или АДИ-0-1

Рисунок 5.2 – Схема подключения

#### 5.4 Ввод в эксплуатацию

Убедиться в целостности пломбы поверителя (оттиска клейма на пломбирочной ленте).

Поднять крышку АДИ и нажать кнопку доступа (разрешения/запрета конфигурирования). С помощью ПО «АДИ КОНФИГУРАТОР» выполнить сброс архива измеренных величин. Повторно нажать кнопку доступа и убедиться в запрете конфигурирования.

Убедиться в соответствии значения «Контрольная сумма калибровок» данным паспорта [5.1] и отчёта о настройках (приложение А). Убедиться в соответствии значения «Контрольная сумма настроек» данным отчёта о настройках.

Для защиты от несанкционированного изменения настройки установить крышку и опломбировать путём установки навесной пломбы по рисунку 5.3. Пломбирование выполняется инспектором снабжающей организации.

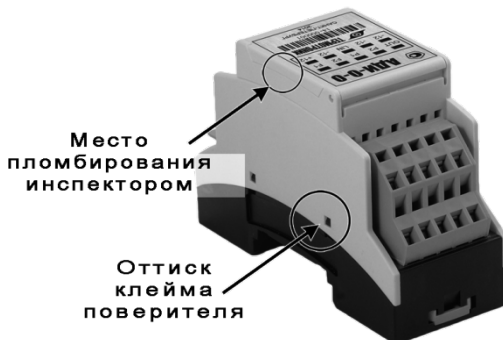


Рисунок 5.3 – Пломбирование

## 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Использование определяется заданной конфигурацией АДИ и характеристиками внешних устройств, подключённых к АДИ.

**ВНИМАНИЕ!** Для выполнения измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, допускается использовать **ТОЛЬКО** поверенные измерительные каналы АДИ!

Вычисление объёма воды  $V$ , м<sup>3</sup> выполняется по формуле (1)

$$V = 10^{-3} \times V_N \times N \quad (1),$$

где  $V$  – заданное при настройке значение веса импульса, л/имп.;  $N$  – измеренное на входе ( $V_1$ ,  $V_2$ ) количество импульсов.

Вычисление избыточного давления воды  $P$ , МПа выполняется по формуле (2)

$$P = P_{\max} \times (I - I_N) / (I_B - I_N) \quad (2),$$

где  $P_{\max}$  – заданное при настройке значение максимального давления, МПа;  $I$  – измеренное на входе ( $P_1$ ,  $P_2$ ) значение тока, мА;  $I_N$  – заданное (по умолчанию) нижнее значение диапазона тока,  $I_N = 4$  мА;  $I_B$  – заданное (по умолчанию) верхнее значение диапазона тока,  $I_B = 20$  мА.

Только для исполнений АДИ-1-0, АДИ-1-1: преобразование текущего расхода (по цифровому сигналу от расходомера «Питерфлоу РС») в значение постоянного тока  $I$  в диапазоне от 4 до 20 мА на выходе OUT выполняется по формуле (3)

$$I = I_N + I_B \times (G - G_{\min}) / (G_{\max} - G_{\min}) \quad (3),$$

где  $I_N$  – заданное (по умолчанию) нижнее значение диапазона тока,  $I_N = 4$  мА;  $I_B$  – заданное (по умолчанию) верхнее значение диапазона тока,  $I_B = 20$  мА;  $G$  – измеренное на входе (LIN) значение расхода, м<sup>3</sup>/ч;  $G_{\min}$  – заданное при настройке минимальное значение диапазона расхода, м<sup>3</sup>/ч;  $G_{\max}$  – заданное при настройке максимальное значение диапазона расхода, м<sup>3</sup>/ч.

Архив измеренных величин, диагностическая информация, параметры настройки представляются на ПК с помощью ПО «АРХИВАТОР».

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание АДИ включает в себя внешний осмотр, проверку работоспособности и периодическую поверку.

### 7.1 Внешний осмотр и проверка работоспособности

*Один раз в год*

Убедиться в отсутствии внешних повреждений АДИ, в целостности пломб, в надёжности электрических соединений. При необходимости выполнить затяжку крепёжных и электрических соединений. Принять меры для сохранения пломб (оттисков клейм) при эксплуатации!

С помощью ПО «АРХИВАТОР» выполнить считывание архива измеренных величин и убедиться в нормальном функционировании АДИ.

### 7.2 Периодическая поверка

*Один раз в четыре года (межповерочный интервал)*

Поверку АДИ выполнять по методике поверки [5.2] с использованием ПО «АДИ ПОВЕРКА».

После поверки убедиться в том, что АДИ опломбирован поверителем, а в паспорт [5.1] внесена запись о поверке, включающая значение «Контрольная сумма калибровок».

## 8 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед устранением неисправностей убедиться в надёжности контактов, в отсутствии обрыва, короткого замыкания или замыкания на землю линий связи, в соответствии полярности сигналов, а также в корректности заданных настроечных параметров.

Выявленные неисправности устраняют только на предприятии-изготовителе или в сервисном центре. Заполнить акт рекламации [5.4], упаковать АДИ в жёсткую тару так, чтобы исключить его повреждение при транспортировании, и направить АДИ вместе с паспортом [5.1] и актом рекламации [5.4] на предприятие-изготовитель или в сервисный центр для ремонта.

## 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование АДИ осуществлять в штатной упаковке всеми видами транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков и пыли.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до 55 °С;
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С не более 95 %;
- вибрация частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм.

## 10 ХРАНЕНИЕ

Хранение АДИ осуществлять в штатной упаковке в отапливаемых помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных газов, паров воды, пыли. Конденсация влаги не допускается. Расстояние до отопительных устройств: не менее 0,5 м.

Условия хранения:

- температура окружающего воздуха от 10 до 30 °С;
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С не более 95 %.

Консервация и обслуживание АДИ при хранении не требуется.

## Приложение А – Пример отчёта

### ОТЧЕТ О НАСТРОЙКАХ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ	Адаптер измерительный:	АДИ-0-1
	Серийный номер:	012345
	Аппаратная версия:	АВ 02.00
	Программная версия:	ПВ 01.01
	Контрольная сумма ПО:	11АВ.4F32
	Контрольная сумма настроек:	A963
	Контрольная сумма калибровок:	1897
ОБЩИЕ	Сетевой адрес:	240
	Отчетный час:	23
	Отчетные сутки:	31
	Наличие Питерфлю:	да
	Скорость обмена (бит/сек.):	9600
Вход V1	Тип входа:	счет имп.
	Уровень сигнала:	НЗ
	Вес импульса (л/имп.):	1
	Время антидребезга (мс):	10
Вход V2	Тип входа:	дискр.вход
	Уровень сигнала:	НЗ
	Вес импульса (л/имп.):	0
	Время антидребезга (мс):	10
Вход P1	Pmax (МПа):	1.6
Вход P2	Pmax (МПа):	1.6
Выход ОУТ(дискр.)	Событие:	G> max
	Уставка min:	0
	Уставка max:	8

Дата создания 21.07.2016 13:12:34

## Ссылочные нормативные документы

- 1.1 ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. <2 ХАРАКТЕРИСТИКИ. 4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ><sup>2</sup>
- 1.2 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). <2 ХАРАКТЕРИСТИКИ>
- 2.1 МИ 3286-2010 Рекомендация. Проверка защиты программного обеспечения и определение её уровня при испытаниях средств измерений в целях утверждения типа. <3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА>
- 3.1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6. <4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ>
- 3.2 ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утверждённые постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 №3 (ред. от 20.02.2003). <4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ>
- 4.1 Карта заказа. Преобразователи измерительные АДИ. <ВВЕДЕНИЕ>
- 5.1 ТРОН.407290.004 ПС Преобразователь измерительный АДИ. Паспорт. <3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА. 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 8 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ>
- 5.2 МП 2550-0145-2014 Преобразователи измерительные АДИ. Методика поверки. <7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ>
- 5.3 ТУ 4217-004-65987520-2014. Преобразователи измерительные АДИ. Технические условия. <1 НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЯ>
- 5.4 Акт рекламации. Преобразователи измерительные АДИ. <8 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ>

---

<sup>2</sup> Здесь и далее в угловых скобках <...> указаны разделы руководства, в которых дана ссылка на нормативный документ.